

Hieff NGS[®] Ultima Dual-mode mRNA Library Prep Kit

兼容 Illumina 和 MGI 双平台以及双模式 mRNA 建库试剂盒

12309ES

产品使用说明书

Ver. CN20230825

A decorative graphic at the bottom of the page consisting of several overlapping, wavy shapes in various shades of orange and yellow, creating a modern, organic feel.

目录

产品简介	1
产品信息	1
组分信息	1
储存条件	1
使用说明	1
mRNA 文库构建操作步骤	4
Part I: Illumina®平台 mRNA 文库构建操作步骤	4
PartII: MGI®平台 mRNA 文库构建操作步骤	8
附录	12
附录一: mRNA 片段化效果展示	12
附录二: Illumina 平台分选条件说明	12
附录三: MGI 平台分选条件说明	15
注意事项	17

产品简介

HiEFF NGS® Ultima Dual-mode mRNA Library Prep Kit是兼容 Illumina 和 MGI 双平台的 mRNA 转录组文库构建试剂盒，本试剂盒将 cDNA 二链合成与 Endprep、dA-tailing 进行合并，极大地缩减建库时间。二链合成模块配有两种 Buffer，客户可根据需要进行常规建库或链特异性建库。本产品适用于起始模板为 10 ng-4 μg 不同来源真核生物总 RNA 样本。经过 mRNA 分离、片段化、双链 cDNA 合成、末端修复、加 A 尾、接头连接和文库扩增，总 RNA 样品最终转化为兼容 Illumina®和 MGI®平台测序的文库。

试剂盒包含两个独立模块，BOX-I 的核心为纯化 mRNA 所需的 oligo (dT)磁珠。BOX-II 包含 mRNA 片段化试剂，反转录试剂，常规和链特异性 ds-cDNA 合成，以及后续建库所需的所有试剂。其中链特异性二链合成 Buffer 中将 dTTP 替换为 dUTP，使 cDNA 第二链中掺入 dUTP，而本试剂盒使用的高保真 DNA 聚合酶无法扩增含尿嘧啶的 DNA 模板，实现链特异性。提供的所有试剂都经过严格的质量控制和功能验证，最大程度上保证了文库构建的稳定性和重复性。

产品信息

货号	12309ES08 / 12309ES24 / 12309ES96
规格	8 T / 24 T / 96 T

组分信息

组分编号	组分名称	12309ES08	12309ES24	12309ES96
BOX-I	12603-A ○ mRNA Capture Beads	0.4 mL	1.2 mL	4.8 mL
	12603-B ○ Beads Binding Buffer	0.4 mL	1.2 mL	4.8 mL
	12603-C ⊙ Beads Wash Buffer	5 mL	15 mL	60 mL
	12603-D ○ Tris Buffer	0.4 mL	1.2 mL	4.8 mL
BOX-II	12309-A ● Frag/Prime Buffer	150 μL	450 μL	2×900 μL
	12309-B ● 1st Strand Enzyme Mix	16 μL	48 μL	192 μL
	12309-C ● Strand Specificity Reagent	50 μL	150 μL	580 μL
	12309-D ● 2nd Strand Buffer (dNTP)	240 μL	720 μL	2×1440 μL
	12309-E ● 2nd Strand Buffer (dUTP)	240 μL	720 μL	2×1440 μL
	12309-F ● 2nd Strand Enzyme Master Mix	40 μL	120 μL	480 μL
	12309-G ● Ligation Enhancer	240 μL	720 μL	2×1440 μL
	12309-H ● Novel T4 DNA Ligase	40 μL	120 μL	480 μL
	12309-I ⊕ 2×Super Canace® II High-Fidelity Mix	200 μL	600 μL	2×1200 μL
	12309-* * Primer mix	NA	NA	NA

注：primer mix 为建库必须试剂，但该成分不包含在本试剂盒，需要额外配置。本试剂盒组分兼容 Illumina 和 MGI 双平台，但需要额外配置专属于 Illumina®或者 MGI®的 primer mix(Cat# 13335 Primer Mix for Illumina®以及 Cat# 13334 Primer Mix for MGI®)。

储存条件

Box I: 2~8°C保存、Box II: -25~-15°C保存。有效期 1 年。

使用说明

实验前请仔细阅读：

一、关于接头连接(Adapter Ligation)

1. 本公司可提供 Illumina® 或者 MGI® 长接头(Barcoded Adapter)试剂盒和短接头试剂盒, 客户可根据实验需求进行选择。
2. 我们建议选用高质量的商业化接头, 如客户使用自制接头, 请委托具有 NGS 引物合成经验的公司, 并备注需进行严格的防污染控制。此外, 进行接头退火操作时, 请在超净台完成。每次只操作一种接头, 防止交叉污染。
3. 使用接头时, 请提前将接头取出放在 4°C 或冰盒上解冻; 室温操作时, 实验室温度最好不要超过 25°C, 防止接头解链。
4. 建库过程中, 接头浓度过高或过低都会导致建库成功率变低。本试剂盒操作方案中, 所加入的接头体积固定为 5 μ L, 请根据初始的 RNA 投入量, 参考表 1 对接头进行稀释。接头稀释液请选择 0.1 \times TE buffer, 稀释过的接头可在 4°C 保存 48 h。

表 1-1 Input Total RNA 量与 Illumina 接头浓度推荐表

Input Total RNA	Illumina Adapter stock concentration
10 ng	1 μ M
100 ng	1.5 μ M
500 ng	3 μ M
≥ 1 μ g	5 μ M

表 1-2 Input Total RNA 量与 MGI 接头使用浓度推荐表

Input Total RNA	MGI Adapter stock concentration
100-499 ng	2 μ M
500-4000 ng	5 μ M

*可根据不同类型 Total RNA 样本及投入量, 按需求适当调整 Adapter 使用量

二、关于磁珠纯化与分选 (Bead-based Clean Up and Size Selection)

1. 建库过程中有多个步骤需要使用 DNA 纯化磁珠, 我们推荐使用 Hieff NGS® DNA Selection Beads (Yeasen Cat#12601) 或 AMPure® XP 磁珠(Beckman Cat#A63880)进行 DNA 纯化和分选。
2. 磁珠使用前应先平衡至室温, 否则会导致得率下降、分选效果不佳。
3. 磁珠每次使用前都应充分振荡混匀或使用移液器上下吹打充分混匀。
4. 转移上清时, 请勿吸取磁珠, 即使微量残留都将影响后续文库质量。
5. 磁珠洗涤使用的 80%乙醇应现用现配, 否则将影响回收效率。
6. 产物洗脱前应将磁珠置于室温干燥。干燥不充分容易造成无水乙醇残留影响后续反应; 过分干燥又会导致磁珠开裂进而降低纯化得率。通常情况下, 室温干燥 3-5 min 足以让磁珠充分干燥。
7. DNA 纯化或长度分选产物如需保存, 可使用 0.1 \times TE Buffer 洗脱, 产物于 4°C 可保存 2 天, -20°C 可保存 1 个月。

三、关于文库扩增 (Library Amplification)

1. 本试剂盒中的文库扩增组分由本公司第二代高保真 DNA 聚合酶所组成, 在第一代的基础上, 大大增强了扩增的均一性, 即使是低拷贝的基因, 也能进行无偏好性地扩增。
2. 文库扩增步骤需要严格控制扩增循环数。循环数不足, 将导致文库产量低; 循环数过多, 又将导致文库偏好性增加、重复度增加、嵌合产物增加、扩增突变积累等多种不良后果。表 2 列举了使用本试剂盒进行文库扩增, Input Total RNA 量与相应扩增循环数的推荐。

表 2 Input Total RNA 量与扩增循环数推荐表*

Input Total RNA	Number of cycles	
	Non-stranded	Stranded
10 ng	15	15
100 ng	14	14
500 ng	12	13
1 µg	11	12

【注】：*由于文库产量不仅与投入量和扩增循环数相关，样本质量、片段化条件、分选条件等都会影响产量。建库过程中请根据实际情况综合考虑，选择最合适的建库条件。

四、自备材料 (Other Materials)

1. DNA 纯化磁珠：Hieff NGS® DNA Selection Beads (Yeasen Cat#12601)或 AMPure® XP Beads (A63880)或其他等效产品。
2. RNA 质检：Agilent 2100 Bioanalyzer RNA 6000 Nano/Pico Chip 或其他等效产品。
3. Adapters: Complete Adapter for Illumina®使用 (Cat#13519-13520 或其他等效产品) 或 Complete Adapter for MGI®使用 (Cat#13360-13362 或其他等效产品) 。
4. 文库质检：Agilent 2100 Bioanalyzer DNA 1000 Chip/ High Sensitivity Chip 或其他等效产品；文库定量试剂。
5. 其他材料：无水乙醇、无菌超纯水、低吸附枪头、PCR 管、磁力架、PCR 仪等。

五、操作流程

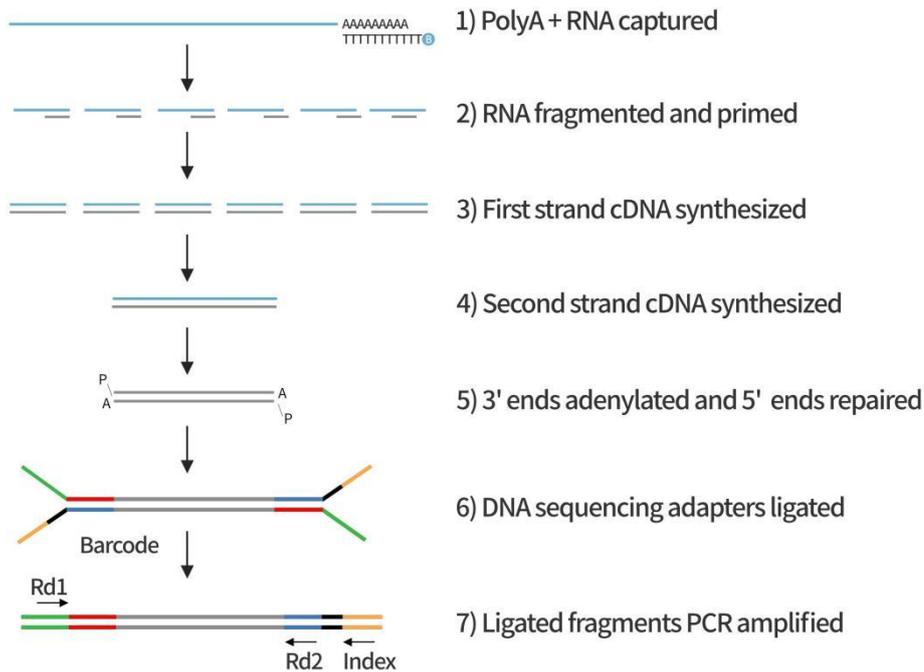


图 1 mRNA 建库试剂盒流程原理流程图

mRNA 文库构建操作步骤

Part I: Illumina®平台 mRNA 文库构建操作步骤

1.1 mRNA 纯化和片段化 (mRNA Purification and Fragmentation)

1. 将 mRNA Capture Beads 从 2-8°C 取出，静置使其温度平衡至室温，约 30 min。
2. 准备一个 Nuclease free 离心管，取 10 ng-4 µg 总 RNA，用 Nuclease Free 水将体积补至 50 µL，冰上放置备用。
3. 颠倒或旋涡振荡混匀磁珠，吸取 50 µL 磁珠悬液加入至 50 µL 总 RNA 样品中，用移液器吹打 6 次，使其充分混匀。
4. 将磁珠与 RNA 的混合物置于 PCR 仪中，65°C，5 min；25°C，5 min；25°C，hold，完成 RNA 与捕获磁珠的结合。
5. 将样品置于磁力架中，室温静置 5 min，使 mRNA 与总 RNA 分离，小心移除上清。
6. 将样品从磁力架上取出，用 200 µL Beads Wash Buffer 重悬磁珠，移液器反复吹打 6 次以彻底混匀。将样品置于磁力架中，室温静置 5 min，小心移除上清。
7. 重复步骤 6，共洗涤两次。
8. 将样品从磁力架上取出，加入 50 µL Tris Buffer 重悬磁珠，用移液器反复吹打 6 次以彻底混匀。
9. 将样品置于 PCR 仪中，80°C，2 min；25 °C，hold，将 mRNA 洗脱下来。
10. 将样品从 PCR 仪中取出，加入 50 µL Beads Binding Buffer，用移液器反复吹打 6 次以彻底混匀。
11. 室温放置 5 min，使 mRNA 结合到磁珠上。
12. 将样品置于磁力架中，室温静置 5 min，小心移除上清。
13. 将样品从磁力架上取出，用 200 µL Beads Wash Buffer 重悬磁珠，移液器反复吹打 6 次以彻底混匀，将样品重新放回至磁力架中，室温静置 5 min，吸掉全部上清。

【注】：最后需要用 10 µL 移液器吸干净残留液体。

14. 将样品从磁力架上取出，用 18.5 µL Frag/Prime Buffer 重悬磁珠，用移液器吹打 6 次以彻底混匀；将样品置于 PCR 仪中（预设为 94°C），可参考表 3 选择片段化程序，但不同物种片段化的效果有差异，客户可先根据自己的情况，做个片段化时间的梯度，比如 94°C，5 min。使用 Agilent 2100 分析 mRNA 纯化产物大小。

表 3 mRNA 片段化程序推荐

插入片段大小 (bp)	打断程序
200-300	94°C, 10 min, 4°C hold
300-400	94°C, 7 min, 4°C hold
400-500	94°C, 5 min, 4°C hold

15. 片段化程序结束后，为防止 poly(A)尾 RNA 与磁珠结合，请立即将样品置于磁力架中，待溶液澄清后，转移 17 µL 上清至一个新的 Nuclease Free 离心管中，立刻进入第一链 cDNA 合成。

1.2 第一链 cDNA 的合成

1. 将第一链合成试剂从 -20°C 取出，颠倒混匀后瞬离。按表 4 所示，配制第一链 cDNA 合成的反应液。

表 4 第一链 cDNA 合成反应体系

名称	体积 (µL)
Fragmented mRNA	17
Strand Specificity Reagent	6
1st Strand Enzyme Mix	2
Total	25

2. 使用移液器轻轻吹打混匀，瞬离将反应液离心至管底。

3. 将上述 PCR 管置于 PCR 仪中，按照表 5 所示设置反应程序，进行第一链 cDNA 的合成。反应结束后立即进行第二链 cDNA 的合成。

表 5 第一链 cDNA 合成反应程序

温度	时间
热盖 105 °C	On
25 °C	10 min
42 °C	15 min
70 °C	15 min
4 °C	Hold

1.3 第二链 cDNA 的合成/末端修复/加 A

1. 将第二链合成试剂从-20 °C 取出，解冻后颠倒混匀；按照表 6 所示，配制第二链 cDNA 合成/末端修复/加 A 反应液。

表 6 第二链 cDNA 合成反应体系

名称	体积 (μL)
1st Strand cDNA	25
2nd Strand Buffer (dNTP or dUTP)*	30
2nd Strand Enzyme Master Mix	5
Total	60

【注】：*如构建普通 mRNA 文库，请使用含 dNTP 的 Buffer；如构建链特异性 mRNA 文库，请使用含 dUTP 的 Buffer。

2. 使用移液器轻轻吹打混匀，瞬离将反应液离心至管底。

3. 将上述 PCR 管置于 PCR 仪中，按照表 7 所示设置反应程序，进行第二链 cDNA 的合成。

表 7 第二链 cDNA 合成反应程序

温度	时间
热盖 105 °C	on
16 °C	30 min
72 °C	15 min
4 °C	Hold

1.4 接头连接 (Adapter Ligation)

该步骤可在末端修复和 dA 尾添加的产物末端，连接特定的 Illumina® 接头。

1. 参考注意事项三中的表 1-1，根据 Input RNA 量，稀释 Adapter 至合适浓度。

2. 将表 8 中各试剂解冻后颠倒混匀，置于冰上备用。

3. 于 3.3 步骤结束后的 PCR 管中继续配制表 8 所示反应体系。

表 8 Adapter Ligation 体系

名称	体积 (μL)
dA-tailed DNA	60
Ligation Enhancer	30*
Novel T4 DNA Ligase	5
DNA Adapter	5**
Total	100

【注】：*Ligation Enhancer 使用前请上下颠倒、振荡，充分混匀并瞬时离心后使用。

**本公司接头原始浓度为 15 μM，请根据注意事项二表 1-1 的提示，根据投入量对接头进行稀释，使接头添加体积固定为 5 μL。

- 使用移液器轻轻吹打混匀，并短暂离心将反应液收集至管底。
- 将 PCR 管置于 PCR 仪中，设置表 9 所示反应程序，进行接头连接反应：

表 9 Adapter Ligation 反应程序

温度	时间
热盖	Off
20°C	15 min
4°C	Hold

1.5 连接产物纯化(Clean Up Post Ligation)

本方案适用于片段 < 200 bp 时，通过两次纯化去除体系中的接头残留；当插入片段 ≥ 200 bp 时，参照附录二的分选方案，通过纯化、分选或者直接分选获得目标长度的文库。

适用于插入片段 < 200 bp 的文库（需进行两轮纯化）：

- 准备工作：将 Hieff NGS® DNA Selection Beads 磁珠由冰箱中取出，室温平衡至少 30 min，同时配制 80%乙醇。
- 涡旋振荡或充分颠倒磁珠以保证充分混匀。
- 吸取 60 μL Hieff NGS® DNA Selection Beads (0.6×, Beads:DNA=0.6:1) 至 Adapter Ligation 产物中，涡旋或吹打混匀，室温孵育 5 min。
- 将 PCR 管短暂离心并置于磁力架中分离磁珠和液体，待溶液澄清后（约 5 min），小心移除上清。
- 保持 PCR 管始终置于磁力架中，加入 200 μL 新鲜配制的 80%乙醇漂洗磁珠，室温孵育 30 sec 后，小心移除上清。
- 重复步骤 5，总计漂洗两次。
- 保持 PCR 管始终置于磁力架中，开盖空气干燥磁珠至刚刚出现龟裂（不超过 5 min）。
- 将 PCR 管从磁力架中取出，加入 52 μL ddH₂O，涡旋振荡或使用移液器轻轻吹打至充分混匀，室温静置 5 min。将 PCR 管短暂离心并置于磁力架中静置，待溶液澄清后（约 3 min），小心移取 50 μL 上清至新 PCR 管中，再进行一轮纯化。
- 吸 40 μL Hieff NGS® DNA Selection Beads (0.8×, Beads:DNA=0.8:1) 至上一步产物中，涡旋或吹打混匀，室温孵育 5 min。
- 将 PCR 管短暂离心并置于磁力架中分离磁珠和液体，待溶液澄清后（约 3 min），小心移除上清。
- 保持 PCR 管始终置于磁力架中，加入 200 μL 新鲜配制的 80%乙醇漂洗磁珠，室温孵育 30 sec 后，小心移除上清。
- 重复步骤 11，总计漂洗两次。
- 保持 PCR 管始终置于磁力架中，开盖空气干燥磁珠至刚刚出现龟裂（不超过 5 min）。
- 将 PCR 管从磁力架中取出，加入 21 μL ddH₂O，涡旋振荡或使用移液器轻轻吹打至充分混匀，室温静置 5 min。将 PCR 管短暂离心并置于磁力架中静置，待溶液澄清后（约 3 min），小心移取 20 μL 上清至新 PCR 管中，进行 PCR 扩增。

1.6 文库扩增 (Library Amplification)

该步骤将对纯化或长度分选后的接头连接产物进行 PCR 扩增富集。

- 将表 10 中的试剂解冻后颠倒混匀，置于冰上备用。
- 于无菌 PCR 管中配制表 10 所示反应体系。

表 10-A 短接头连接产物 PCR 反应体系

组分名称	体积(μL)
2× Super Canace® II High-Fidelity Mix	25
Universal Primer/ i5 Primer*	2.5
Index Primer/ i7 Primer*	2.5
Adapter Ligated DNA	20
Total	50

表 10-B 长接头连接产物 PCR 反应体系

组分名称	体积 (μL)
2× Super Canace® II High-Fidelity Mix	25
Primer Mix**	5
Adapter Ligated DNA	20
Total	50

【注】：*如果使用的是无 Index 的接头，俗称短接头（小 Y 接头），请使用短接头试剂(Cat#12414~ Cat#12415)中配备的 Index primer 进行扩增。

**如果您使用的是 Indexed Adapter (Cat#13519~ Cat#13520)，俗称长接头（大 Y 接头），可用 Cat#13335 中的 Hieff NGS® Primer Mix for Illumina® 进行扩增。

3. 使用移液器轻轻吹打或振荡混匀，并短暂离心将反应液收集至管底。

4. 将 PCR 管置于 PCR 仪中，设置表 11 示反应程序，进行 PCR 扩增。

表 11 PCR 扩增反应程序

温度	时间	循环数
热盖 105 °C	on	
98°C	1 min	1
98°C	10 sec	11~15 cycles *
60°C	30 sec	
72°C	30 sec	
72°C	5 min	1
4°C	Hold	-

【注】：*文库扩增循环数需根据样本质量、投入量等建库条件进行调整，详见注意事项五（表 2）。

1.7 扩增产物磁珠纯化(Clean Up Post Amplification)

1. 准备工作：将 Hieff NGS® DNA Selection Beads 磁珠由冰箱中取出，室温平衡至少 30 min，同时配制 80%乙醇。

2. 涡旋振荡或充分颠倒磁珠以保证充分混匀。

3. 吸取 45 μL Hieff NGS® DNA Selection Beads (0.9×, Beads:DNA=0.9:1)至 Adapter Ligation 产物中，涡旋或吹打混匀，室温孵育 5 min。

4. 将 PCR 管短暂离心并置于磁力架中分离磁珠和液体，待溶液澄清后（约 5 min），小心移除上清。

5. 保持 PCR 管始终置于磁力架中，加入 200 μL 新鲜配制的 80%乙醇漂洗磁珠，室温孵育 30 sec 后，小心移除上清。

6. 重复步骤 5，总计漂洗两次。

7. 保持 PCR 管始终置于磁力架中，开盖空气干燥磁珠至刚刚出现龟裂（不超过 5 min）。

8. 将 PCR 管从磁力架中取出，加入 21 μL ddH₂O，涡旋振荡或使用移液器轻轻吹打至充分混匀，室温静置 5 min。将 PCR 管短暂离心并置于磁力架中静置，待溶液澄清后（约 3 min），小心移取 20 μL 上清至新 PCR 管中，进行文库定量、质检。

1.8 文库质量控制

通常情况下，构建好的文库可通过浓度检测和长度分布检测来进行质量评价，具体请参见注意事项五。

PartII: MGI®平台 mRNA 文库构建操作步骤

2.1 mRNA 纯化和片段化 (mRNA Purification and Fragmentation)

1. 将 mRNA Capture Beads 从 2-8°C 取出, 静置使其温度平衡至室温, 约 30 min。
2. 准备一个 Nuclease free 离心管, 取 10 ng-4 μg 总 RNA, 用 Nuclease Free 水将体积补至 50 μL, 冰上放置备用。
3. 颠倒或旋涡振荡混匀磁珠, 吸取 50 μL 磁珠悬液加入至 50 μL 总 RNA 样品中, 用移液器吹打 6 次, 使其充分混匀。
4. 将磁珠与 RNA 的混合物置于 PCR 仪中, 65°C, 5 min; 25°C, 5 min; 25°C, hold, 完成 RNA 与捕获磁珠的结合。
5. 将样品置于磁力架中, 室温静置 5 min, 使 mRNA 与总 RNA 分离, 小心移除上清。
6. 将样品从磁力架上取出, 用 200 μL Beads Wash Buffer 重悬磁珠, 移液器反复吹打 6 次以彻底混匀。将样品置于磁力架中, 室温静置 5 min, 小心移除上清。
7. 重复步骤 6, 共洗涤两次。
8. 将样品从磁力架上取出, 加入 50 μL Tris Buffer 重悬磁珠, 用移液器反复吹打 6 次以彻底混匀。
9. 将样品置于 PCR 仪中, 80°C, 2 min; 25°C, hold, 将 mRNA 洗脱下来。
10. 将样品从 PCR 仪中取出, 加入 50 μL Beads Binding Buffer, 用移液器反复吹打 6 次以彻底混匀。
11. 室温放置 5 min, 使 mRNA 结合到磁珠上。
12. 将样品置于磁力架中, 室温静置 5 min, 小心移除上清。
13. 将样品从磁力架上取出, 用 200 μL Beads Wash Buffer 重悬磁珠, 移液器反复吹打 6 次以彻底混匀, 将样品重新放回至磁力架中, 室温静置 5 min, 吸掉全部上清。

【注】: 最后需要用 10 μL 移液器吸干净残留液体。

14. 将样品从磁力架上取出, 用 18.5 μL Frag/Prime Buffer 重悬磁珠, 用移液器吹打 6 次以彻底混匀; 将样品置于 PCR 仪中 (预设为 94°C), 可参考表 12 选择片段化程序, 但不同物种片段化的效果有差异, 客户可先根据自己的情况, 做个片段化时间的梯度, 比如 94°C, 5 min。使用 Agilent 2100 分析 mRNA 纯化产物大小。

表 12 mRNA 片段化程序推荐

插入片段大小 (bp)	打断程序
200-300	94°C, 10 min, 4°C hold;
300-400	94°C, 7 min, 4°C hold;
400-500	94°C, 5 min, 4°C hold;

15. 片段化程序结束后, 为防止 poly(A)尾 RNA 与磁珠结合, 请立即将样品置于磁力架中, 待溶液澄清后, 转移 17 μL 上清至一个新的 Nuclease Free 离心管中, 立刻进入第一链合成反应。

2.2 第一链 cDNA 的合成:

1. 将第一链合成试剂从 -20°C 取出, 颠倒混匀后瞬离。按表 13 所示, 配制第一链 cDNA 合成的反应液。

表 13 第一链 cDNA 合成反应体系

名称	体积 (μL)
Fragmented mRNA	17
Strand Specificity Reagent	6
1st Strand Enzyme Mix	2
Total	25

2. 使用移液器轻轻吹打混匀, 瞬离将反应液离心至管底。
3. 将上述 PCR 管置于 PCR 仪中, 按照表 14 所示设置反应程序, 进行第一链 cDNA 的合成。反应结束后立即进行第二链 cDNA 的合成。

表 14 第一链 cDNA 合成反应程序

温度	时间
热盖 105°C	On
25°C	10 min
42°C	15 min
70°C	15 min
4°C	Hold

2.3 第二链 cDNA 的合成/末端修复/加 A:

1. 将第二链合成试剂从-20 °C 取出，解冻后颠倒混匀；按照表 15 所示，配制第二链 cDNA 合成/末端修复/加 A 反应液。

表 15 第二链 cDNA 合成反应体系

名称	体积 (μL)
1st Strand cDNA	25
2nd Strand Buffer (dNTP or dUTP)*	30
2nd Strand Enzyme Master Mix	5
Total	60

【注】：*如构建普通 mRNA 文库，请使用含 dNTP 的 buffer；如构建链特异性 mRNA 文库，请使用含 dUTP 的 buffer。

2. 使用移液器轻轻吹打混匀，瞬间将反应液离心至管底。
3. 将上述 PCR 管置于 PCR 仪中，按照表 16 所示设置反应程序，进行第二链 cDNA 的合成。

表 16 第二链 cDNA 合成反应程序

温度	时间
热盖 105°C	on
16°C	30 min
72°C	15 min
4°C	Hold

2.4 接头连接 (Adapter Ligation)

该步骤可在末端修复和 dA 尾添加的产物末端，连接特定的 MGI[®] 接头。

1. 参考注意事项三中的表 1-2，根据 Input RNA 量，稀释 Adapter 至合适浓度。
2. 将表 17 中各试剂解冻后颠倒混匀，置于冰上备用。
3. 于 4.3 步骤结束后的 PCR 管中继续配制表 17 所示反应体系。

表 17 Adapter Ligation 体系

名称	体积 (μL)
dA-tailed DNA	60
Ligation Enhancer	30*
Novel T4 DNA Ligase	5
DNA Adapter	5**
Total	100

【注】：*Ligation Enhancer 使用前请上下颠倒、振荡，充分混匀并瞬时离心后使用。

**本公司接头原始浓度为 10 μM，请根据注意事项二表 1-2 的提示，根据投入量对接头进行稀释，使接头添加体积固定为 5 μL。

4. 使用移液器轻轻吹打混匀，并短暂离心将反应液收集至管底。
5. 将 PCR 管置于 PCR 仪中，设置表 18 所示反应程序，进行接头连接反应：

表 18 Adapter Ligation 反应程序

温度	时间
热盖	Off
20°C	15 min
4°C	Hold

2.5 连接产物纯化 (Post Ligation Clean Up)

本方案适用于片段 < 200 bp 时，通过两次纯化去除体系中的接头残留；当插入片段 ≥ 200 bp 时，参照附录三的分选方案，通过纯化、分选获得目标长度的文库。

适用于插入片段 < 200 bp 的文库 (需进行两轮纯化)

1. 准备工作：将 Hieff NGS® DNA Selection Beads 磁珠由冰箱中取出，室温平衡至少 30 min，同时配制 80%乙醇。
2. 涡旋振荡或充分颠倒磁珠以保证充分混匀。
3. 吸取 60 μL Hieff NGS® DNA Selection Beads (0.6×, Beads:DNA=0.6:1) 至 Adapter Ligation 产物中，涡旋或吹打混匀，室温孵育 5 min。
4. 将 PCR 管短暂离心并置于磁力架中分离磁珠和液体，待溶液澄清后 (约 5 min)，小心移除上清。
5. 保持 PCR 管始终置于磁力架中，加入 200 μL 新鲜配制的 80%乙醇漂洗磁珠，室温孵育 30 sec 后，小心移除上清。
6. 重复步骤 5，总计漂洗两次。
7. 保持 PCR 管始终置于磁力架中，开盖空气干燥磁珠至刚刚出现龟裂 (不超过 5 min)。
8. 将 PCR 管从磁力架中取出，加入 52 μL ddH₂O，涡旋振荡或使用移液器轻轻吹打至充分混匀，室温静置 5 min。将 PCR 管短暂离心并置于磁力架中静置，待溶液澄清后 (约 3 min)，小心移取 50 μL 上清至新 PCR 管中，再进行一轮纯化。
9. 吸取 40 μL Hieff NGS® DNA Selection Beads (0.8×, Beads:DNA=0.8:1) 至上一步产物中，涡旋或吹打混匀，室温孵育 5 min。
10. 将 PCR 管短暂离心并置于磁力架中分离磁珠和液体，待溶液澄清后 (约 3 min)，小心移除上清。
11. 保持 PCR 管始终置于磁力架中，加入 200 μL 新鲜配制的 80%乙醇漂洗磁珠，室温孵育 30 sec 后，小心移除上清。
12. 重复步骤 11，总计漂洗两次。
13. 保持 PCR 管始终置于磁力架中，开盖空气干燥磁珠至刚刚出现龟裂 (不超过 5 min)。
14. 将 PCR 管从磁力架中取出，加入 21 μL ddH₂O，涡旋振荡或使用移液器轻轻吹打至充分混匀，室温静置 5 min。将 PCR 管短暂离心并置于磁力架中静置，待溶液澄清后 (约 3 min)，小心移取 20 μL 上清至新 PCR 管中，进行 PCR 扩增。

2.6 文库扩增 (Library Amplification)

该步骤将对纯化或长度分选后的接头连接产物进行 PCR 扩增富集。

该步骤将对纯化或长度分选后的接头连接产物进行 PCR 扩增富集。

1. 将表 19 中的试剂解冻后颠倒混匀，置于冰上备用。
2. 于无菌 PCR 管中配制表 19 所示反应体系。

表 19 接头连接产物 PCR 反应体系

组分名称	体积 (μL)
2× Super Canace® II High-Fidelity Mix	25
Primer Mix for MGI**	5
Adapter Ligated DNA	20

【注】：*该 primer mix for MGI 不含在本试剂盒中，可用 Cat#13334 中的 Hieff NGS® Primer Mix for MGI® 进行扩增。

3. 使用移液器轻轻吹打或振荡混匀，并短暂离心将反应液收集至管底。

4. 将 PCR 管置于 PCR 仪中，设置表 20 示反应程序，进行 PCR 扩增。

表 20 PCR 扩增反应程序

温度	时间	循环数
热盖 105 °C	on	
98°C	1 min	1
98°C	10 sec	11~15cycles*
60°C	30 sec	
72°C	30 sec	
72°C	5 min	1
4°C	Hold	-

*文库扩增循环数需根据样本质量、投入量等建库条件进行调整，详见注意事项五（表 2）。

2.7 扩增产物磁珠纯化 (Post Amplification Clean Up)

1. 准备工作：将 Hieff NGS® DNA Selection Beads 磁珠由冰箱中取出，室温平衡至少 30 min，同时配制 80%乙醇。
2. 涡旋振荡或充分颠倒磁珠以保证充分混匀。
3. 吸取 45 μL Hieff NGS® DNA Selection Beads (0.9×, Beads:DNA=0.9:1) 至 Adapter Ligation 产物中，涡旋或吹打混匀，室温孵育 5 min。
4. 将 PCR 管短暂离心并置于磁力架中分离磁珠和液体，待溶液澄清后（约 5 min），小心移除上清。
5. 保持 PCR 管始终置于磁力架中，加入 200 μL 新鲜配制的 80%乙醇漂洗磁珠，室温孵育 30 sec 后，小心移除上清。
6. 重复步骤 5，总计漂洗两次。
7. 保持 PCR 管始终置于磁力架中，开盖空气干燥磁珠至刚刚出现龟裂（不超过 5 min）。
8. 将 PCR 管从磁力架中取出，加入 21 μL ddH₂O，涡旋振荡或使用移液器轻轻吹打至充分混匀，室温静置 5 min。将 PCR 管短暂离心并置于磁力架中静置，待溶液澄清后（约 3 min），小心移取 20 μL 上清至新 PCR 管中，进行文库定量、质检。

2.8 文库质量控制

通常情况下，构建好的文库可通过浓度检测和长度分布检测来进行质量评价，具体请参见注意事项五。

附录

附录一：mRNA 片段化效果展示

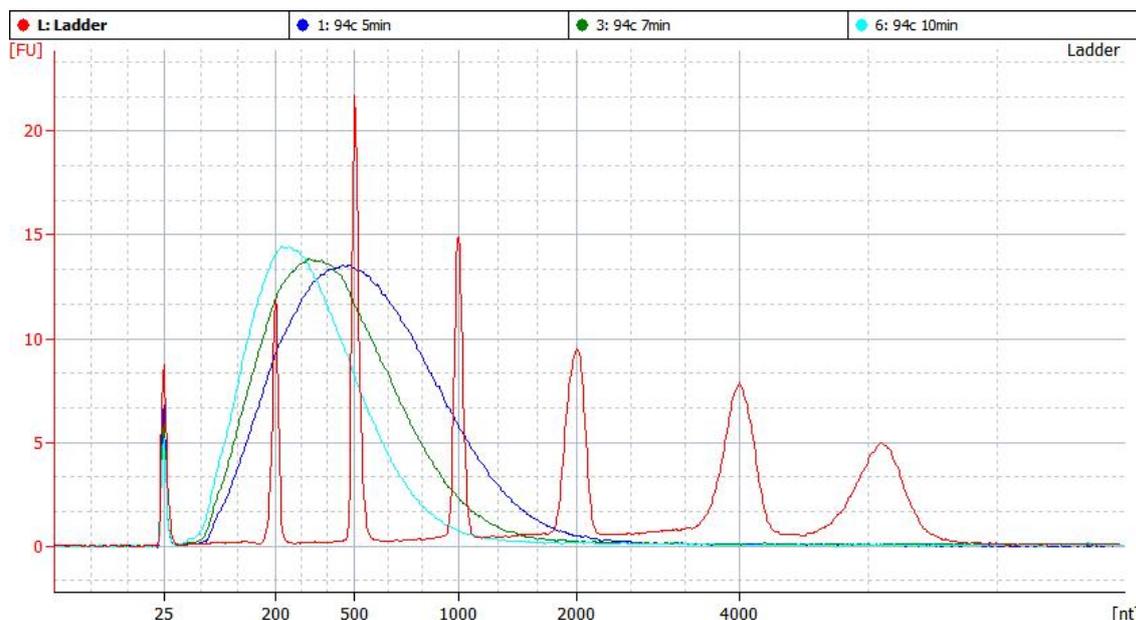


图 2. mRNA 不同打断时间对应的 RNA 片段范围。分别以 94°C, 10 min、94°C, 7min 和 94°C, 5 min 处理。打断后 mRNA 进行 2.2×磁珠纯化，通过 Agilent 2100 Bioanalyzer 进行检测。

【注】：本结果使用的 RNA 是 Agilent 公司的 Universal Human Reference RNA，若使用其他来源的 RNA，最好优化打断时间。

附录二：Illumina 平台分选条件说明

分选方案适用于 94°C, 10 min、94°C, 7 min 和 94°C, 5 min 片段化的 RNA 建库，可以获得插入片段大于 200 bp 的文库：

方案一：接头连接产物纯化后分选

★ 0.6× Hieff NGS® DNA Selection Beads 接头连接产物的纯化

1. 准备工作：将 Hieff NGS® DNA Selection Beads 磁珠由冰箱中取出，室温平衡至少 30 min，同时配制 80%乙醇。
2. 涡旋振荡或充分颠倒磁珠以保证充分混匀。
3. 吸取 60 μL Hieff NGS® DNA Selection Beads (0.6×, Beads:DNA=0.6:1)至 Adapter Ligation 产物中，涡旋或吹打混匀，室温孵育 5 min。
4. 将 PCR 管短暂离心并置于磁力架中分离磁珠和液体，待溶液澄清后（约 5 min），小心移除上清。
5. 保持 PCR 管始终置于磁力架中，加入 200 μL 新鲜配制的 80%乙醇漂洗磁珠，室温孵育 30 sec 后，小心移除上清。
6. 重复步骤 5，总计漂洗两次。
7. 保持 PCR 管始终置于磁力架中，开盖空气干燥磁珠至刚刚出现龟裂（不超过 5 min）。
8. 将 PCR 管从磁力架中取出，加入 102 μL ddH₂O，涡旋振荡或使用移液器轻轻吹打至充分混匀，室温静置 5 min。将 PCR 管短暂离心并置于磁力架中静置，待溶液澄清后（约 5 min），小心移取 100 μL 上清至新 PCR 管中，准备进行双轮分选。

★ 双轮分选（以 94 °C, 7 min 打断，分选文库大小为 410 bp~510 bp 为例，其他文库大小按推荐比例进行磁珠分选）当选择短接头（小 Y 接头）进行连接后纯化，使用双端 384 种 Index Primers: Hieff NGS® RNA 384 CDI Primers Kit for Illumina®, Set 1~Set 2 (Cat#12414~Cat#12415)进行 RNA 建库时，分选比例参照表 21 进行，当选择长接头（大 Y 接头），

使用 Indexed Adapters: Hieff NGS® Complete Adapter Kit for Illumina®, Set 1~Set 4 (Cat#13519~Cat#13520)进行连接后纯化, 分选比例参照表 22 进行。

1. 请涡旋振荡或充分颠倒磁珠以保证混匀。
2. 根据 DNA 片段长度要求, 参考表 21, 在上述 100 μL DNA 中加入第一轮分选磁珠 65 μL (0.65 \times), 涡旋或移液器吹打 10 次混匀。
室温孵育 5 min。
4. 将 PCR 管短暂离心并置于磁力架中, 待溶液澄清后 (约 5 min), 小心转移上清到干净的离心管中, 残留 1-2 μL 溶液管底。
5. 参考表 21 向上清中加入第二轮分选磁珠 15 μL (0.15 \times)。
6. 涡旋混匀或移液器吹打 10 次混匀, 室温静置 5 min。
7. 将 PCR 管短暂离心并置于磁力架中, 待溶液澄清后 (约 3 min), 小心移除上清。
8. 保持 PCR 管始终处于磁力架中, 加入 200 μL 新鲜配制的 80%乙醇漂洗磁珠, 室温孵育 30 sec, 小心移除上清。
9. 重复步骤 8。
10. 保持 PCR 管始终处于磁力架中, 开盖干燥磁珠至刚刚出现龟裂 (约 3 min)。
11. 将 PCR 管从磁力架中取出, 加入 21 μL ddH₂O, 涡旋振荡或使用移液器轻轻吹打充分混匀, 室温静置 5 min。
12. 将 PCR 管短暂离心并置于磁力架中分离磁珠和液体。待溶液澄清后 (约 3 min), 小心转移 20 μL 上清至干净管中。

表 21 短接头文库分选推荐磁珠比例

插入片段长度 (bp)	200~300	250~350	350~450	450~550
文库长度(bp)	260~360	310~410	410~510	510~610
打断条件	94 °C 10 min	94 °C 7 min	94 °C 7 min	94 °C 5 min
第一轮磁珠体积(μL)	80 (0.8 \times)	75 (0.75 \times)	65 (0.65 \times)	60 (0.6 \times)
第二轮磁珠体积 (μL)	15 (0.15 \times)	15 (0.15 \times)	15 (0.15 \times)	10 (0.1 \times)

表 22 长接头文库分选推荐磁珠比例

插入片段长度(bp)	200~300	250~350	350~450	450~550
文库长度(bp)	320~420	370~470	470~570	570~670
打断条件	94 °C 10 min	94 °C 7 min	94 °C 7 min	94 °C 5 min
第一轮磁珠体积(μL)	75 (0.75 \times)	70 (0.7 \times)	65 (0.65 \times)	60 (0.6 \times)
第二轮磁珠体积(μL)	15 (0.15 \times)	15 (0.15 \times)	15 (0.15 \times)	10 (0.1 \times)

【注】：表 21、22 推荐的双轮分选比例适用于 Hieff NGS® DNA Selection Beads; 表中“ \times ”表示样品 DNA 体积。如所需文库插入片段主峰为 300 bp 时, 若在短接头连接之后分选, 样品 DNA 体积为 100 μL , 则第一轮分选磁珠使用体积为 $0.65 \times 100 \mu\text{L} = 65 \mu\text{L}$, 第二轮分选磁珠使用体积为 $0.15 \times 100 \mu\text{L} = 15 \mu\text{L}$; 若在长接头连接之后分选, 样品 DNA 体积为 100 μL , 则第一轮分选磁珠使用体积为 $0.65 \times 100 \mu\text{L} = 65 \mu\text{L}$, 第二轮分选磁珠使用体积为 $0.15 \times 100 \mu\text{L} = 15 \mu\text{L}$ 。

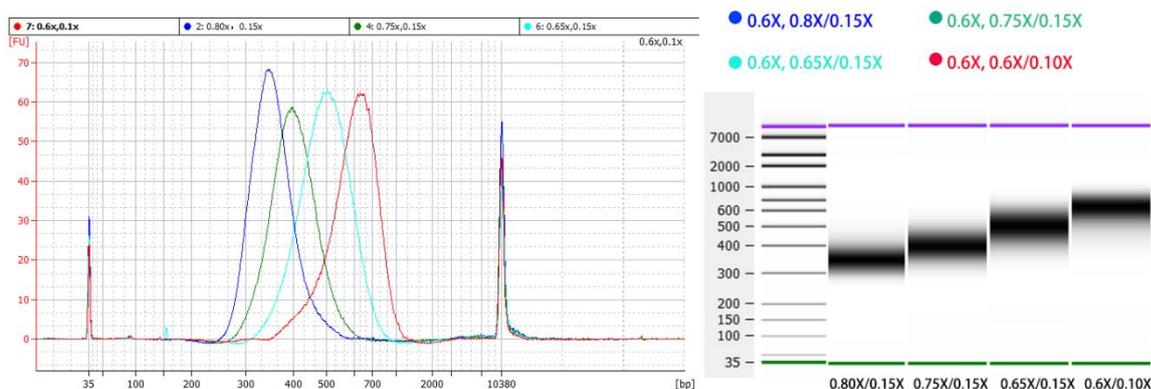


图 3.1 μg 293 total RNA, 在 94°C 10 min, 94°C 7 min 和 94°C 5 min 片段化后, 根据表 21 推荐磁珠比例得到的文库大小

方案二：接头连接产物直接分选（以 94°C , 7 min 打断, 分选文库大小为 410 bp~510 bp 为例说明, 其他文库大小按推荐比例进行磁珠分选）

500 ng 以上的总 RNA 做 mRNA 抓取后建库, 推荐直接分选, 体系比较粘稠, 需要小心添加, RNA 质量略差样本可能会有接头残留。

当选择短接头（小 Y 接头）进行连接后纯化, 使用双端 384 种 Index Primers: Hieff NGS[®] RNA 384 CDI Primer Kit for Illumina[®], Set 1~Set 2 (Cat#12414~Cat#12415) 进行 RNA 建库时, 分选比例参照表 23 进行, 当选择长接头（大 Y 接头）, 使用 Indexed Adapters: Hieff NGS[®] Complete Adapter Kit for Illumina[®], Set 1~Set 4 (Cat#13519~Cat#13520) 进行连接后纯化, 分选比例参照表 24 进行。

1. 请涡旋振荡或充分颠倒磁珠以保证混匀。
2. 根据 DNA 片段长度要求, 参考表 23, 在上述 100 μL 的连接体系中加入第一轮分选磁珠 20 μL (0.20 \times), 涡旋或移液器吹打 10 次混匀。室温孵育 10 min。
3. 将 PCR 管短暂离心并置于磁力架中, 待溶液澄清后（约 5 min）, 小心转移 100 μL 上清到干净的离心管中。
4. 参考表 23 向上清中加入第二轮分选磁珠 10 μL (0.10 \times)。
5. 涡旋混匀或移液器吹打 10 次混匀, 室温静置 10 min。
6. 将 PCR 管短暂离心并置于磁力架中, 待溶液澄清后（约 3 min）, 小心移除上清。
7. 保持 PCR 管始终处于磁力架中, 加入 200 μL 新鲜配制的 80%乙醇漂洗磁珠, 室温孵育 30 sec, 小心移除上清。
8. 重复步骤 7。
9. 保持 PCR 管始终处于磁力架中, 开盖干燥磁珠至刚刚出现龟裂（约 3 min）。
10. 将 PCR 管从磁力架中取出, 加入 21 μL ddH₂O, 涡旋振荡或使用移液器轻轻吹打充分混匀, 室温静置 5 min。
11. 将 PCR 管短暂离心并置于磁力架中分离磁珠和液体。待溶液澄清后（约 3 min）, 小心转移 20 μL 上清至干净管中。

表 23 短接头文库分选推荐磁珠比例

插入片段长度(bp)	200~300	250~350	350~450	450~550
文库长度(bp)	260~360	310~410	410~510	510~610
打断条件	94°C 10 min	94°C 7 min	94°C 7 min	94°C 5 min
第一轮磁珠体积(μL)	25 (0.25 \times)	25 (0.25 \times)	20 (0.2 \times)	18 (0.18 \times)
第二轮磁珠体积 (μL)	10 (0.1 \times)	10 (0.1 \times)	10 (0.1 \times)	10 (0.1 \times)

表 24 长接头文库分选推荐磁珠比例

插入片段长度 (bp)	200~300	250~350	350~450	450~550
文库长度 (bp)	320~420	370~470	470~570	570~670
打断条件	94 °C 10 min	94 °C 7 min	94 °C 7 min	94 °C 5 min
第一轮磁珠体积(μL)	25 (0.25×)	20 (0.2×)	18 (0.18×)	18 (0.18×)
第二轮磁珠体积 (μL)	10 (0.1×)	10 (0.1×)	10 (0.1×)	10 (0.1×)

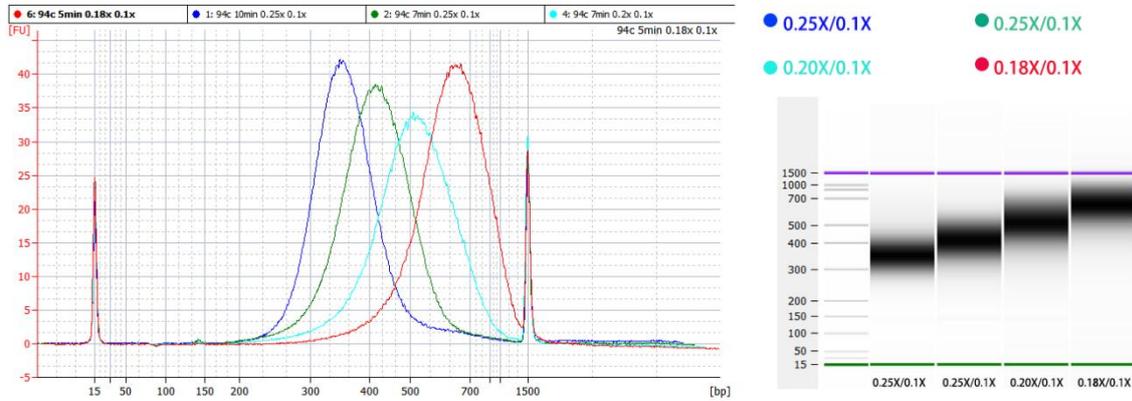


图 4.1 μg 293 total RNA, 在 94 °C 10 min、94 °C 7 min 和 94 °C 5 min 片段化后, 根据表 23 推荐磁珠比例得到的文库

附录三：MGI 平台分选条件说明

分选方案适用于 94°C, 10 min、94°C, 7 min 和 94°C, 5 min 片段化的 RNA 建库, 可以获得插入片段大于 200 bp 的文库:

方案一：接头连接产物纯化后分选

★ 0.6× Hieff NGS® DNA Selection Beads 接头连接产物的纯化

1. 准备工作: 将 Hieff NGS® DNA Selection Beads 磁珠由冰箱中取出, 室温平衡至少 30 min, 同时配制 80%乙醇。
2. 涡旋振荡或充分颠倒磁珠以保证充分混匀。
3. 吸取 60 μL Hieff NGS® DNA Selection Beads (0.6×, Beads:DNA=0.6:1) 至 Adapter Ligation 产物中, 涡旋或吹打混匀, 室温孵育 5 min。
4. 将 PCR 管短暂离心并置于磁力架中分离磁珠和液体, 待溶液澄清后 (约 5 min), 小心移除上清。
5. 保持 PCR 管始终置于磁力架中, 加入 200 μL 新鲜配制的 80%乙醇漂洗磁珠, 室温孵育 30 sec 后, 小心移除上清。
6. 重复步骤 5, 总计漂洗两次。
7. 保持 PCR 管始终置于磁力架中, 开盖空气干燥磁珠至刚刚出现龟裂 (不超过 5 min)。
8. 将 PCR 管从磁力架中取出, 加入 102 μL ddH₂O, 涡旋振荡或使用移液器轻轻吹打至充分混匀, 室温静置 5 min。将 PCR 管短暂离心并置于磁力架中静置, 待溶液澄清后 (约 5 min), 小心移取 100 μL 上清至新 PCR 管中, 准备进行双轮分选。

★ 双轮分选 (以 94°C, 7 min 打断, 分选文库大小为 380 bp~480 bp 为例说明, 其他文库大小按推荐比例进行磁珠分选)

1. 请涡旋振荡或充分颠倒磁珠以保证混匀。
2. 根据 DNA 片段长度要求, 参考表 25, 在上述 100 μL DNA 中加入第一轮分选磁珠 65 μL (0.65×), 涡旋或移液器吹打 10 次混匀。

室温孵育 5 min。

4. 将 PCR 管短暂离心并置于磁力架中，待溶液澄清后（约 5 min），小心转移上清到干净的离心管中，残留 1-2 μL 溶液管底。
5. 参考表 25 向上清中加入第二轮分选磁珠 15 μL (0.15 \times)。
6. 涡旋混匀或移液器吹打 10 次混匀，室温静置 5 min。
7. 将 PCR 管短暂离心并置于磁力架中，待溶液澄清后（约 3 min），小心移除上清。
8. 保持 PCR 管始终处于磁力架中，加入 200 μL 新鲜配制的 80%乙醇漂洗磁珠，室温孵育 30 sec，小心移除上清。
9. 重复步骤 8。
10. 保持 PCR 管始终处于磁力架中，开盖干燥磁珠至刚刚出现龟裂（约 3 min）。
11. 将 PCR 管从磁力架中取出，加入 21 μL ddH₂O，涡旋振荡或使用移液器轻轻吹打充分混匀，室温静置 5 min。
12. 将 PCR 管短暂离心并置于磁力架中分离磁珠和液体。待溶液澄清后（约 3 min），小心转移 20 μL 上清至干净管中。

表 25 长接头文库分选推荐磁珠比例

插入片段长度 (bp)	200~300	300~400	400~500	500~600
文库长度 (bp)	280~380	380~480	480~580	580~680
打断条件	94°C 10 min	94°C 7 min	94°C 7 min	94°C 5 min
第一轮磁珠体积(μL)	70 (0.7 \times)	65 (0.65 \times)	58 (0.58 \times)	50 (0.5 \times)
第二轮磁珠体积 (μL)	20 (0.2 \times)	15 (0.15 \times)	15 (0.15 \times)	15 (0.15 \times)

【注】：此表推荐的双轮分选比例适用于 HiSeq NGS® DNA Selection Beads；表中“ \times ”表示样品 DNA 体积。如所需文库插入片段主峰为 300 bp 时，若在长接头连接之后分选，样品 DNA 体积为 100 μL ，则第一轮分选磁珠使用体积为 $0.65 \times 100 \mu\text{L} = 65 \mu\text{L}$ ，第二轮分选磁珠使用体积 $0.15 \times 100 \mu\text{L} = 15 \mu\text{L}$ 。

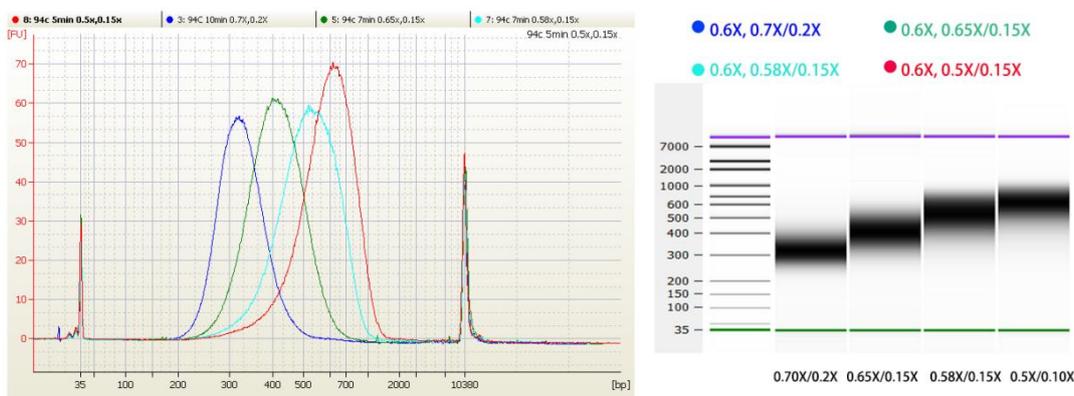


图 5. 1 μg 293T total RNA，在 94°C，10 min、94°C，7 min 和 94°C，5 min 片段化后，根据表 25 推荐的磁珠比例得到的文库大小。

方案二：接头连接产物直接分选（以 94°C，7 min 打断，分选文库大小为 410 bp~510 bp 为例说明，其他文库大小按推荐比例进行磁珠分选）

500 ng 以上的总 RNA 做 mRNA 抓取后建库，推荐直接分选，体系比较粘稠，需要小心添加，RNA 质量略差样本可能会有接头残留。

1. 请涡旋振荡或充分颠倒磁珠以保证混匀。
2. 根据 DNA 片段长度要求，参考表 26，在上述 100 μL 的 DNA 连接体系中加入第一轮分选磁珠 20 μL (0.20 \times)，涡旋或移液器吹打 10 次混匀。室温孵育 10 min。
3. 将 PCR 管短暂离心并置于磁力架中，待溶液澄清后（约 5 min），小心转移 100 μL 上清到干净的离心管中，。
4. 参考表 25 向上清中加入第二轮分选磁珠 10 μL (0.10 \times)。
5. 涡旋混匀或移液器吹打 10 次混匀，室温静置 10 min。
6. 将 PCR 管短暂离心并置于磁力架中，待溶液澄清后（约 3 min），小心移除上清。

7. 保持 PCR 管始终处于磁力架中，加入 200 μL 新鲜配制的 80%乙醇漂洗磁珠，室温孵育 30 sec，小心移除上清。
8. 重复步骤 7。
9. 保持 PCR 管始终处于磁力架中，开盖干燥磁珠至刚刚出现龟裂（约 3 min）。
10. 将 PCR 管从磁力架中取出，加入 21 μL ddH₂O，涡旋振荡或使用移液器轻轻吹打充分混匀，室温静置 5 min。
11. 将 PCR 管短暂离心并置于磁力架中分离磁珠和液体。待溶液澄清后（约 3 min），小心转移 20 μL 上清至干净管中。

表 26 长接头文库分选推荐磁珠比例

插入片段长度 (bp)	200~300	300~400	400~500	500~600
文库长度 (bp)	280~380	380~480	480~580	580~680
打断条件	94°C 10 min	94°C 7 min	94°C 7 min	94°C 5 min
第一轮磁珠体积(μL)	25 (0.25 \times)	20 (0.2 \times)	15 (0.15 \times)	15 (0.15 \times)
第二轮磁珠体积 (μL)	10 (0.1 \times)	10 (0.1 \times)	10 (0.1 \times)	10 (0.1 \times)

【注】：此表推荐的双轮分选比例适用于 Hieff NGS® DNA Selection Beads；表中“ \times ”表示样品 DNA 体积。如所需文库插入片段主峰为 300 bp 时，若在长接头连接之后分选，样品 DNA 体积为 100 μL ，则第一轮分选磁珠使用体积为 $0.20 \times 100 \mu\text{L} = 20 \mu\text{L}$ ，第二轮分选磁珠使用体积为 $0.1 \times 100 \mu\text{L} = 10 \mu\text{L}$ 。

注意事项

一、关于操作

1. 本产品仅作科研用途。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并佩戴一次性手套操作。
3. 请于使用前将试剂盒各组份置于室温解冻。解冻后上下颠倒数次充分混匀，短暂离心后置于冰上待用。
4. 推荐在带热盖的 PCR 仪中进行各步骤反应，使用前应预热 PCR 仪至反应温度附近。
5. 请使用无 RNase 污染的耗材，并对实验区域定期进行清理，推荐使用 ThermoFisher 公司的 RNAZap™ 高效核酸去除喷雾去除 RNA 酶污染。
6. PCR 产物因操作不当极易产生气溶胶污染，进而影响实验结果准确性。推荐将 PCR 反应体系配制区和 PCR 产物纯化检测区进行强制性的物理隔离；配备文库构建专用移液器等设备；定时对各实验区域进行清洁（推荐使用 ThermoFisher 公司的 DNAZap™ 高效核酸去除喷雾），以保证实验环境的洁净度。

二、应用范围

- 1 本产品仅作科研用途！
2. 本试剂盒适用于起始模板量为 10 ng-4 μg （体积 $\leq 50 \mu\text{L}$ ）的高质量动物、植物和真菌等真核生物的总 RNA。如初始 RNA 浓度偏低，体积超过 50 μL ，可使用 Hieff NGS® RNA Cleaner 磁珠进行浓缩。RNA 需通过 Agilent 2100 Bioanalyzer RNA 6000 Nano/Pico 芯片检测，RIN 值要求 >7 ，以保证 mRNA 有完整的 poly(A)尾结构。
3. 本试剂盒的 mRNA 分离模块使用的是 oligo (dT)磁珠，只有带 poly(A)尾的 mRNA 才能被提取；其他不具 poly(A)尾的 RNA，如非编码 RNA、无 poly(A)尾的 mRNA 等不能适用本试剂盒。此外，FFPE 样本中的 mRNA 降解严重，通常无完整的 poly(A)尾结构，故亦无法使用本试剂盒进行建库。
4. 本试剂盒所制备文库可进行多种 RNA-Seq 应用，包括：
 - 基因表达(gene expression)
 - 单核苷酸变异检测(single nucleotide variation discovery)
 - 基因融合鉴定(gene fusion identification)
 - 剪切变异体分析(splice variant analysis)



帮助客户创造价值，让世界更健康更快乐